



PT. MERSIFARMA TM
SUKABUMI-INDONESIA

FORMULIR LATAR BELAKANG PERMINTAAN BARANG

Diisi oleh Pemohon

DEPARTEMEN : Produksi Unit 1 Non Steril

No. : 040 /LBPB/ IV /2026

- ☒ Peralatan Produksi
☐ Peralatan Engineering
☐ Peralatan Umum / Logistik / K3
☐ Peralatan Komputer

- ☐ Peralatan Laboratorium
☐ _____
☐ _____
☐ _____

Rencana Waktu Penggunaan:

Lead time Purchasing :

☒ Peralatan Baru

☐ Penambahan

☐ Penggantian

☐ Berita Acara Kerusakan

SYARAT WAJIB PERALATAN BARU DAN PENAMBAHAN:

1. Lampirkan Foto / Brosur / Leaflet / Drawing Peralatan Baru.
2. Lampirkan Estimasi Harga atau Penawaran Harga.
3. Permintaan Peralatan Jenis Baru dibuat hanya sekali untuk awal mendaftarkan ke sistem QAD.
4. Permintaan Penambahan Peralatan jenis yang sama tetap mengisi Formulir dengan melampirkan Histori Peralatan beserta Nomor Inventaris sebelumnya.
5. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

SYARAT WAJIB PENGANTIAN:

1. Lampirkan Foto Peralatan sebelumnya yang akan diganti.
2. Lampirkan Berita Acara Kerusakan.
3. Permintaan Penggantian Peralatan tetap mengisi Formulir dengan menyampaikan penggantian dengan Jenis yang sama dari sebelumnya atau Jenis Baru.
4. Barang diterima oleh Pemohon wajib memberikan Nomor Inventaris sesuai penomoran standar perusahaan.

Nama Barang

Nama & Spesifikasi Barang (Merk, Tipe, dan Keterangan Lainnya)

Jumlah
Unit

Estimasi
Harga

Masa Waktu
Pakai

Masa Frekuensi
Pakai

Water Heater ATM 50A
Kapasitas 50 L

1

>10 thn

Setiap Hari

Latar Belakang Permintaan & Peruntukkan

Water Heater ATM 50A digunakan untuk memanaskan
melarutkan propilen glikol produk mersidol Drops.

Dibuat:

Tgl. : 21/01/26
Nama : Siga

(Koordinator / Supervisor)

Diperiksa & disetujui :

12/01/26
10/01/26

Tgl. :
Nama : _____


(Manager)

Nomor : PP-FO/001.00
Dokumen

Tanggal : **24 DEC 2025**
Berlaku

Disetujui :
Oleh

Lampiran

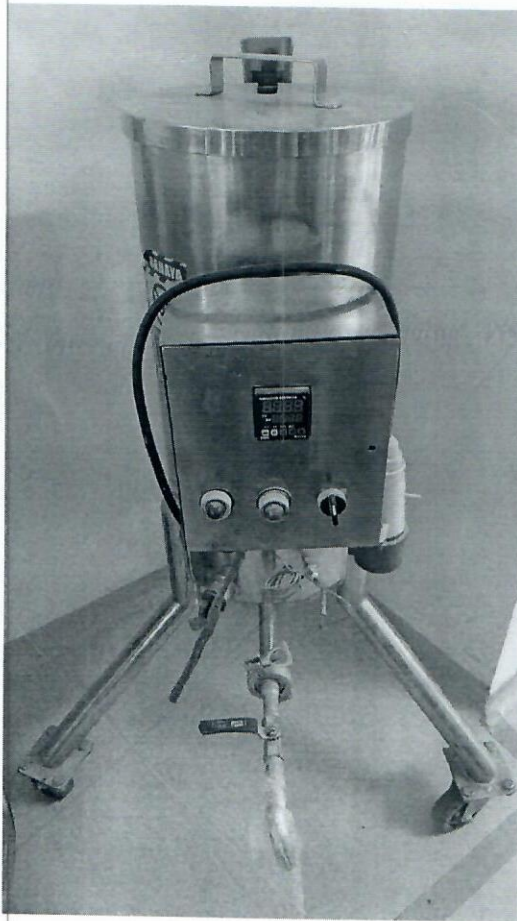


Water Heater ATM 504 kapasitas 50 L

FSMC 01/26/09

PRE-LAUNCHING
MERSIDOL DROPS 100 MG/ ML
KODE SEDIAAN : IPJ00491
Batch Size in L : 50.00 L
Batch Size in Bottle : 3215 Pcs

- Peralatan:
- Wadah SS 60 L (2 pcs)
 - Wadah SS 150 L (1 pcs)
 - Thermometer
 - Water Heater ✓

HIGH RISK: CITRIC ACID ANHYDRATE (LASA)

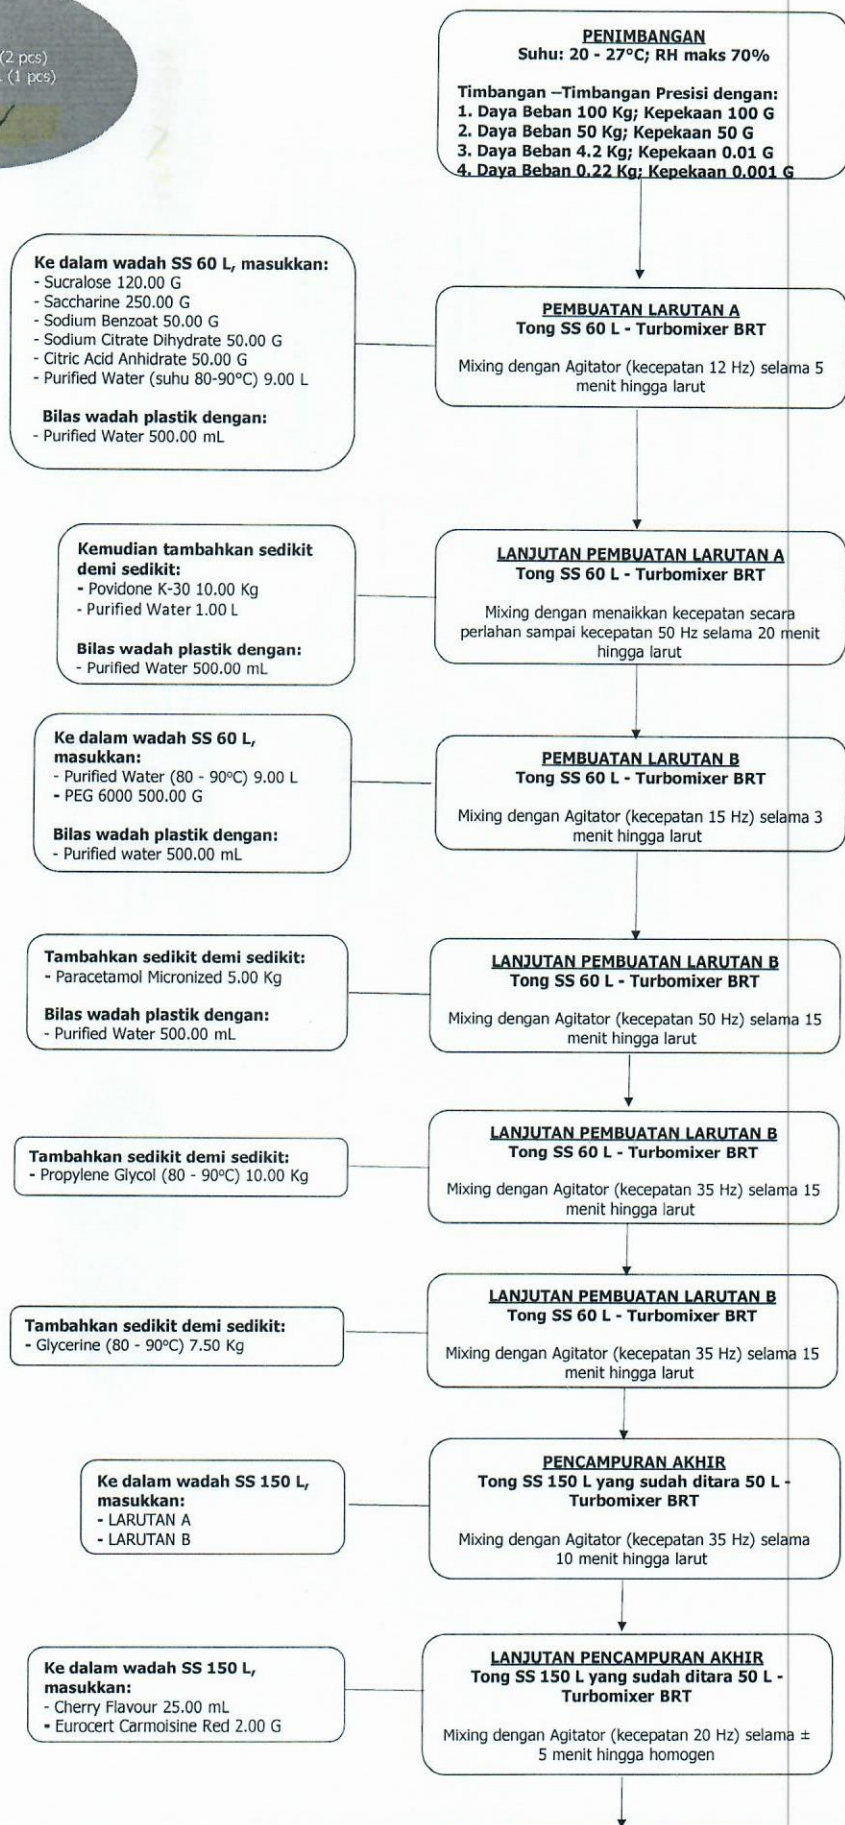

Ke dalam wadah SS 150 L,
masukkan:
- Purified Water ad 50.00 L

LANJUTAN PENCAMPURAN AKHIR
Tong SS 150 L yang sudah ditara 50 L -
Turbomixer BRT

Mixing dengan Agitator (kecepatan 30 Hz) selama $\pm$
5 menit hingga homogen

CEK PH LARUTAN
pH Meter

3.80 - 6.10

KEMAS PRIMER - FILLING BOTOL
Strunk FKHB-02

Vial botol kaca 15 mL amber tipe 1 : 3215 pcs
Dropper pipette D18 : 3215 pcs

PENGEMASAN SEKUNDER-TERSIER
(Manual)

1 karton @ 132 FB @ 1 Vial amber @ 15 mL