

MEMO DINAS Nomor : 258/PRD/MD/VI/2026

Tanggal : 26 Juni 2026
Kepada : Departemen GA
Dari : Departemen Produksi Steril
Tembusan : Arsip
Perihal : Permohonan Penggantian Pita Printer

Dengan hormat,

Sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas hasil pencetakan pada printer yang digunakan untuk kegiatan operasional, bersama ini disampaikan bahwa pita printer Fullmark tipe ERC-09 akan diganti dengan pita printer Print-Rite tipe ERC-09.

Penggantian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penggunaan yang menunjukkan bahwa pita printer Print-Rite ERC-09 menghasilkan kualitas cetak yang lebih jelas, konsisten, dan memiliki tingkat keterbacaan yang lebih baik dibandingkan pita printer yang digunakan sebelumnya. Selain itu, pita printer tersebut memiliki spesifikasi yang kompatibel dengan printer yang digunakan sehingga tidak memengaruhi fungsi maupun kinerja peralatan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Rizqi Ajiwijaya
SPV Produksi Steril


Mengetahui



Yohanes G Reyaan
Manager Produksi Steril


LAMPIRAN

PITA PRINTER PRINT RITE ERC-09

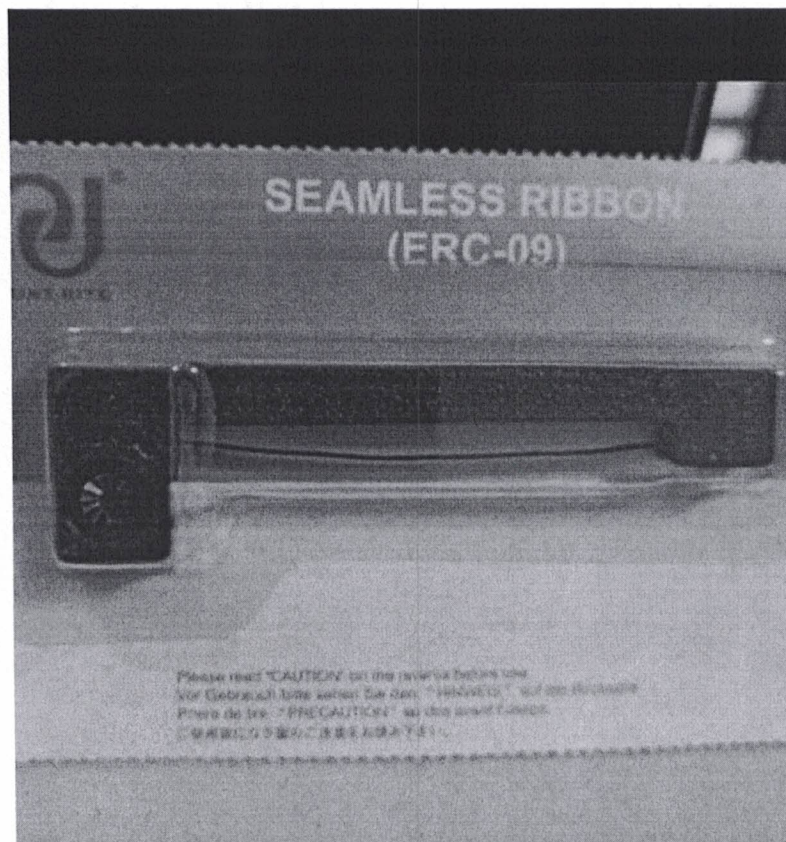

SEAMLESS RIBBON
(ERC-09)

Please read "CAUTION" on the reverse before use.
Vor Gebrauch bitte lesen Sie den "hinweis" auf der Rückseite.
Prière de lire "PRECAUTION" au dos avant l'usage.
（使用前に必ず裏面に注意書きをお読みください。）



Rp23.732
PRINT RITE ERC-09 PURPLE VI...



Beli Sekarang



Toko



Bagikan

Ray 26/26 106 26/26 26