

ANALISA PERMINTAAN BARANG

No	Kode Barang	Nama Barang	Satuan	Stok Saat Ini (A)	Rencana Kebutuhan (B)	Kekurangan (A -B + C)	Pending Penerimaan (C)	Jumlah	Realisasi Pembelian	Realisasi Penggunaan
1	IMO07098	Glass Vessel Clear	Un	0	1	-1	0	1	0	0

Catatan :

Clear Glass Vessel, Part. No: 303-5225, Ex. Pharma Test

- Digunakan untuk wadah / bejana penyimpanan media dan sampel uji pada saat pengujian disolusi.
- Estimasi harga : Rp.7.500.00/Unit.
- Pemesanan terakhir pada bulan April 2024 (PR149756)

Latar Belakang :

- Alat disolusi pharmatest dengan nomor inventaris: C37.001/D.09//RD/INST/06/15 diberikan oleh R&D kepada QC pada tahun 2015 dalam keadaan alat sudah tidak bisa sampling otomatis dan semua bibir vessel sumbing, masa pakai vessel sampai saat ini sudah 11 tahun. Pada tanggal 20 Juli 2026 ditemukan retak pada dinding vessel oleh analis. Melihat masa pakai vessel yang sudah 11 tahun dikhawatirkan meningkatkan potensi vessel tersebut pecah maka dari itu dibutuhkan pengadaan vessel baru, karena vessel merupakan komponen yang bersentuhan langsung dengan produk sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi hasil analisa.

Berita acara alat, kartu perbaikan mesin, gambar instrumen dan penawaran harga.

Dibuat

 10/26
10/08

Mengetahui

 10/26
10/08



PT. LERSIFARMA TM.
ONISI MANUFACTURING
SUKABUMI - INDONESIA -

BERITA ACARA MESIN/ALAT

Form No :
2QA00/FORM016.01
Tgl Berlaku :
15 Oktober 2012
Dibuat oleh :
NLI

DEPARTEMEN : Quality Control



Kerusakan



Perbaikan



Lain-lain

No. urut : /BA-MA/ 1 1

Hari / Tanggal : 20 Juli 2020

Nama Mesin / Alat : Pharmatest / Vessel - Disolusi

Merk / Type : Disolusi Pharmatest

No. Inventaris : C37.001 / D-09 / RD / INST / 06 / 15

Kronologis :

Pada tanggal 20 Juli 2020, Saya melakukan analisa disolusi pharmatest sampel cepezet tablet, setelah melakukan sampling saya istirahat dan kembali ke lab untuk dibereskan / dicuci. Sebelum Vessel saya angkat, Saya melihat keadaan Vessel yang kotor dan menemukan salah satu dinding vessel terdapat retak.

Alat disolusi pharmatest tersebut diberikan oleh RnD kepada QC Sejak 2015 dengan keadaan alat sudah tidak bisa sampling otomatis dan semua bibir vessel sumbing masa pakai vessel sampai saat ini sudah 11 tahun.

Tindakan sementara yang diambil :

Melaporkan temuan retak vessel kepada Spv dan menulis Surat berita acara

Hasil :

Kondisi vessel yang retak dan umurnya yang sudah 11 tahun, meningkatkan potensi vessel tersebut pecah dan tidak dapat digunakan kembali.

Kesimpulan :

Perlu dilakukan pengadaan vessel baru karena vessel merupakan komponen yang bersentuhan langsung dengan produk sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi hasil analisa.

Dilaporkan oleh,


(.....)
AFP

Tanggal : 20-07-2020

Mengetahui,


(.....)
ATS

Tanggal : 20-07-2020


(.....)
NLI

Tanggal :



mersi
PT. MERSIFARMA TM.
DIVISI MANUFACTURING
SUKABUMI-INDONESIA

KARTU PERBAIKAN/SERVICE MESIN

No. Dokumen : 2TK00/FORMU/009.00
Berlaku Tanggal : 17 Oktober 2012
Dibuat Oleh : SDK

NAMA MESIN : Dissolution Tester
NO MESIN : 21212
NO INVENTARIS : C37.001 / D.03 / P-01 / INST / 06 / 15
MANUFACTURER : Pharmatest
TYPE : PT.WI D.610
KAPASITAS :
NEGARA ASAL :
TAHUN PEMBUATAN : Juni 2015
PEMBELIAN :
SUPLIER : PT. Pharmatest Indonesia
LAIN-LAIN :

NO	TANGGAL	KERUSAKAN	PERBAIKAN	WAKTU		PARAF		KET
				Perkiraan	Realisasi	Opt	SPV	
1	03.08.17	Kunjungan rutin	adjustment Gravity adjustment Stirrer Depth	09:15	10:01-14:00	Perry		-
2	16.04.18	Kunjungan rutin	adjustment Gravity - perbaikan shaft 3 - adjust sample weight	10:00-14:00	10:00-14:00	Perry		-
3	22.05.18	pompa tidak berfungsi	- Gak pump - cek pompa	11:00	11:00-14:00	Teddy		- Ret ganti pompa baru
4	14.06.23	Sistem tak bekerja PIC Teknik IT. Mersifarma	- ganti motor - ganti ex probe - ganti blower board - ganti blower board	12:00	14:00	Teddy		- Ret: Heater Board - flow sensor - security sensor
5	03.03.24	Sistem tak bekerja	- pasang flow sensor - pasang security sensor - pasang blower board	09:00	10:00-15:00	Fachrudin		- Housing heater blm ketemu dgn teknik
6	20-03-24	- Ganti tidak Sesuai Sfring Tidak Revisi	- penggantian / heater baru	09:00	11:35	Perry	Alm	- ok - Ganti vessel - Ganti pengunci vessel - Ganti pengunci vessel - Ganti pengunci vessel - Ganti smart ganti - Ganti basket 1 - Rekomendasi pemeliharaan - Ganti sampling - Probe / Rekomendasi - Ganti / pemeliharaan - Flush drum
7	24-9-2024	vessel lock Rusak	Telah dilakukan panggantian	08:30	12:30	Teddy		- Telah diganti Vessel lock - Training ulang drl

Mengetahui,

Petugas

Manager Teknik

Handwritten signature and date: 08/08/24

**KARTU
PERBAIKAN/SERVICE
MESIN**

No. Dokumen : 2TK00/FORMU/009.00
Berlaku Tanggal : 17 Oktober 2012
Dibuat Oleh : SDK

NAMA MESIN	: Dissolution Tester
NO MESIN	: 2/212
NO INVENTARIS	: C 27. 001 / D 03 / H 14 / 06 / 15
MANUFACTURER	: Pharmedist
TYPE	
KAPASITAS	

NEGARA ASAL	:	
TAHUN PEMBUATAN	:	
PEMBELIAN	:	
SUPPLIER	:	
LAIN-LAIN	:	

[illegible]

Mengetahui,



Petugas

Manager Teknik

Handwritten signature: *Chand* 06/02/20

Kondisi Dissolution Tester Pharmatest Type PTWS 1210

No inventaris: C37.001/D.09/RD/INST/06/15

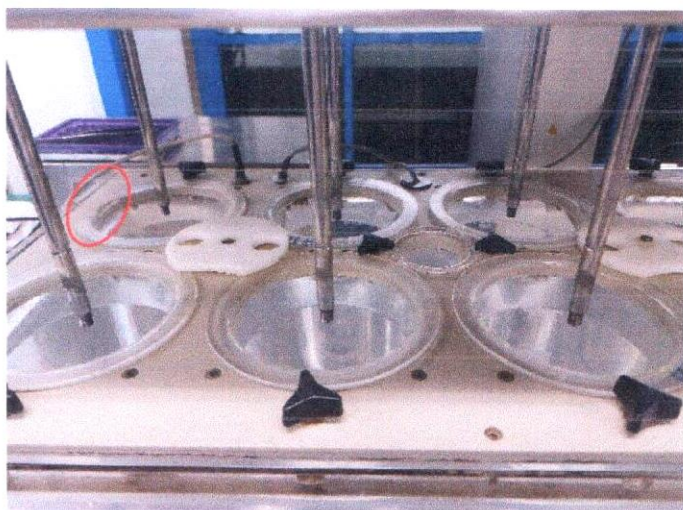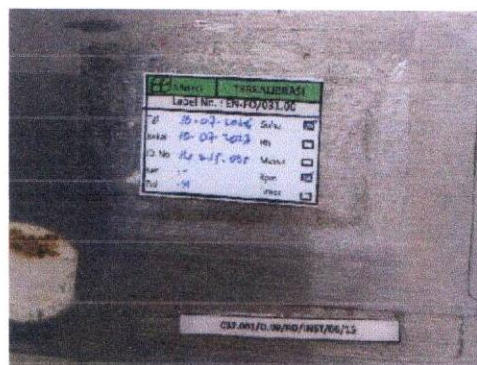

Handwritten signature and date: 06/06/20

PT. PHARMA TEST INDONESIA
RUKAN CROWN BLOK A NO 8
GREEN LAKE CITY
TANGERANG - INDONESIA
PHONE: 021-54318816
HP: 08128796420
E-mail: hans@pharma-test-indo.com
Website: www.pharma-test-indo.com



Quotation

To	PT. Mersifarma	From:	Hans Anthony
Email		Attn:	Ibu Anisa
Our.Reff.	150/Sparepart/VII/26	Date:	22 Juli 2026
Re	QUOTATION Consumable parts	Ttl.Pages:	1 (including this page)

☐ Urgent ☐ For Review ☐ Please Comment ☐ Please Reply ☐ Please Recycle

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Penawaran Harga seperti terlampir, dengan kondisi penawaran sebagai berikut:

No	Description	Qty	List Price	Disc Price
1	Clear Glass Vessel. Part No: 303-5225	1 unit	Rp. 7,500,000	Rp. 6,000,000

Kondisi Penawaran Harga:

- Harga franco Sukabumi.
- Harga BELUM termasuk PPN 11%.
- Delivery: 1-2 minggu.
- Validitas penawaran: 30 Hari.
- Pembayaran: Cash On Delivery

Demikian penawaran harga yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. PHARMA TEST INDONESIA

Hans Anthony
Managing Director